




演示报告

CTA血管智能测量报告

腹主动脉瘤（AAA）

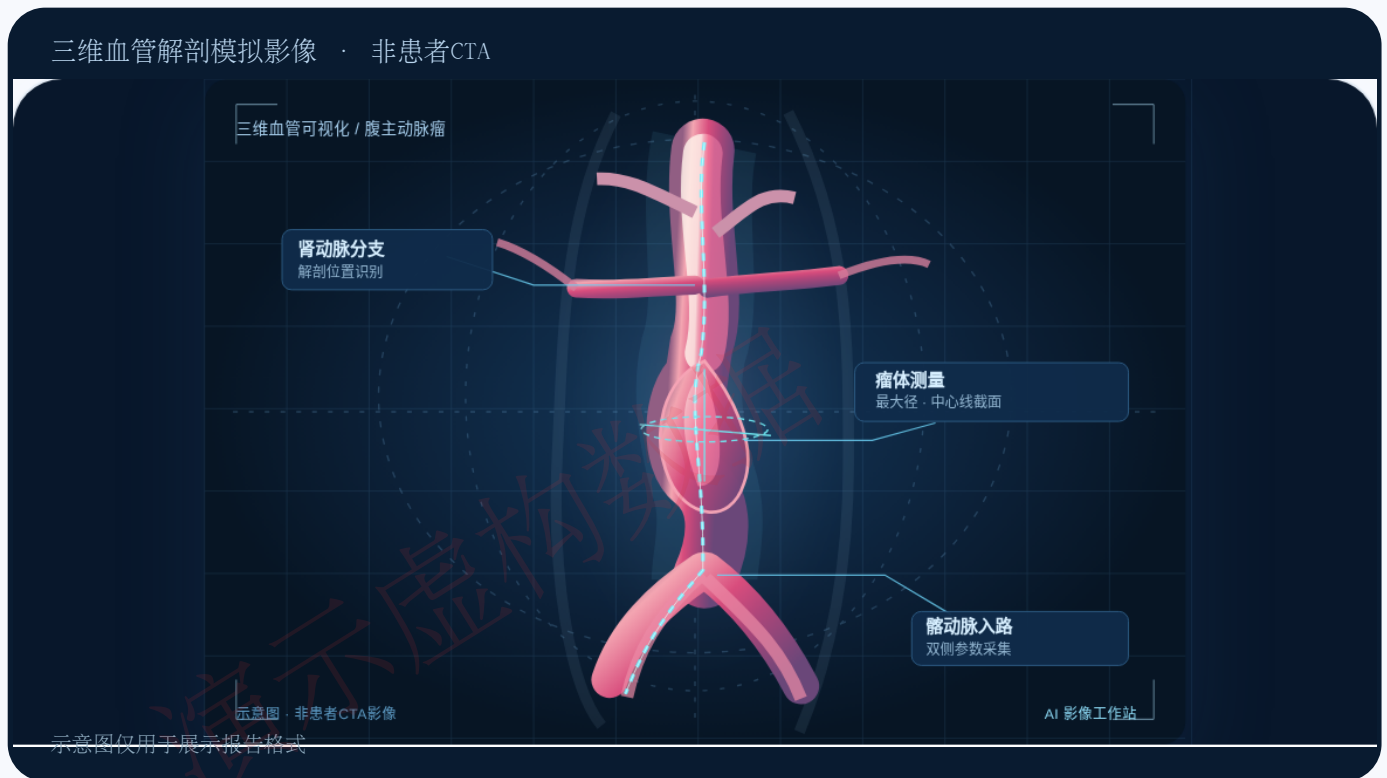

病例编号

DEMO-AAA-001

任务状态

虚构示例

服务内容

测量报告 / 手术规划辅助 / 器械备货参考

重要提示：此文档为网站产品原型展示，三维血管示意图不来自任何真实患者影像。临床应用前必须完成医学影像算法验证、临床质量控制及适用的监管程序。



关键解剖测量参数

本页不构成自动测量准确性证明。

测量项目	结果
瘤体最大直径	56.2 mm
近端瘤颈长度	24.8 mm
近端瘤颈直径	23.6 mm
瘤颈角度	42 °
右髂总动脉直径	13.1 mm
左髂总动脉直径	12.6 mm

医学质控声明

此版本未连接已验证的CTA自动测量模型、中心线提取和专家复核系统。未给出测量结果的病例，不应依据本报告进行手术规划或支架选择。



手术规划与器械备货参考

中立性原则：不因厂家合作关系调整解剖测量或适配条件。

本次选定的厂家（占位名称）

格尔、仙剑

手术规划辅助

当前版本未生成针对患者的治疗建议。拟在具备合规临床验证、产品说明书结构化数据库与人工审核机制后，提供术前解剖要点、锚定区讨论和待核实问题清单。

器械备货参考

厂家及产品型号仅表示用户指定的候选范围。尚未接入获批说明书及真实产品型号目录，不能输出具体支架型号、规格或适配结论。

后续工作

医生核对CTA测量数据

确认医院实际可用产品型号与说明书版本

由具备相应资质的人员确定最终术式与备货